


Izdevīgais komplekta piedāvājums

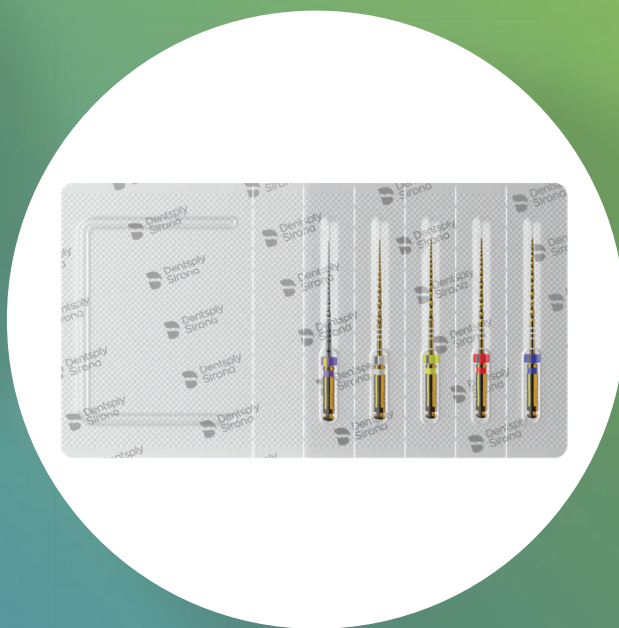

- Pērciet 4 ProTaper Ultimate blisterus un saņemiet 1 ProRoot Bio Sealer komplektu bez maksas.
- Pērciet 1 ProRoot Bio Sealer komplektu un saņemiet 1 ProTaper Ultimate secības blisteri bez maksas.

PRIECĀSIMIES PALĪDZĒT!

Zvani un saņem vairāk par savu pasūtījumu:

Sintija **29 419 005**

Lāsma **26 224 463**

Ilgvars **26 403 453**

Juris **29 356 655**

Divi sileri. Labākais no abām pasaulēm.

Obturācija ir pēdējais un būtiskais solis sakņu kanālu terapija. Dentsply Sirona tagad piedāvā divus klīniski pārbaudītus endodontisko sileru zīmolus, no kuriem katrs ir pielāgots individuālajām ārsta vēlmēm, nodrošinot pārliedību katrā procedūrā.

ProRoot® Bio Sealer Bioceramic Endo Sealer

Labāka bioaktivitāte.
Vai dot priekšroku bioaktīvam
risinājumam sakņu kanālu
hermetizācijai?
ProRoot® Bio Sealer sper soli tālāk.

- Augstāks bioaktīvā cementa saturs¹
- Augsti klīniskie panākumu rādītāji²
- Ērta lietošana ar minimāliem materiāla zudumiem³



Skenējiet,
lai
uzzinātu
vairāk

AH Plus Jet® Endodontic Sealer

AH Plus®. Vienkārši labāks.
Jaunums: uzlabota konsistence
un adhēzija pie gutaperčas.⁴

- Izcilas ilgtermiņa hermetizācijas īpašības⁵
- Īpaši augsta radiopakacitāte⁶
- Piemērots aukstās un siltās obturācijas tehnikām⁷



Skenējiet,
lai
uzzinātu
vairāk

Next
generation



¹ Pamatojoties uz kristāliskās daļas novērtējumu, izmantojot XRD analīzi bioaktīvā cementa satura salīdzināšanai starp dažādiem biokeramiskajiem siliem. Iekšējie dati.

² Randomizēts kontrolēts klīniskais pētījums (vairāk nekā 450 novērošanas gadījumi), salīdzinot biokeramiskos silius ar AH Plus sveķu bāzes siliem. Gustavo De-Deus, Riodežaneiro Universitāte. Ārējie dati.

³ Dažādu biokeramisko sileru uzgaļu materiāla zudumu analīze. Iekšējie dati.

⁴ In vitro pētījums, balstīts uz mikro bīdes saites stiprību (Micro Shear Bond Strength), Gustavo De-Deus. Dati pieejami arhīvā. Metode saskaņā ar Gustavo De-Deus et al., Int Endod J., 2021.

⁵ In vitro pētījums, balstīts uz "Fluid Filtration Model", Gustavo De-Deus. Dati pieejami arhīvā. Metode saskaņā ar De-Deus et al., J Endod, 2007.

⁶ Radiopakacitātes (mmAl/mm) salīdzinājuma testa rezultāti saskaņā ar ISO 6876:2012. Dati pieejami arhīvā.

⁷ Dimensiju stabilitātes salīdzinājuma testa rezultāti saskaņā ar ADA #57 R2012. Iekšējie dati. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties pa e-pastu: Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com

TRUSTED
ENDO
PARTNER